FUJIFILM



V.7.x

CONSOLE ADVANCE

Image Intelligence™

ZAAWANSOWANY

DESIGN



Zaawansowana budowa GUI przekłada się na bezpieczną, wygodną i wydajną pracę podczas wszystkich badań radiograficznych.



Oprócz znanych funkcji podstawowych, nowy monitor o zmienionej gradacji i intuicyjny układ przycisków operacyjnych, umożliwiają szybkie i dokładne potwierdzenie informacji. Znacznie zwiększono obszar wyświetlania na ekranie monitora, co umożliwia łatwe sprawdzenie obrazów diagnostycznych. Opcjonalny monitor z panelem dotykowym zapewnia szybką i dokładną obsługę.



Przyciski wyboru modalności


Wszystkie podłączone modalności wyświetlane są za pomocą kolorowych przycisków, co pozwala radiologowi na łatwe potwierdzenie wybranego modułu. Zmiana możliwa jest jest błyskawicznie poprzez wybranie odpowiedniego przycisku.



Wyświetlanie statusu D-EVO

Ikony D-EVO stanowią zupełnie nową funkcję. W przypadku zastosowania D-EVO umożliwia istnieje możliwość potwierdzenie statusu, poziomu naładowania baterii podłączenia WiFi, itp.

Ekran z listą zadań

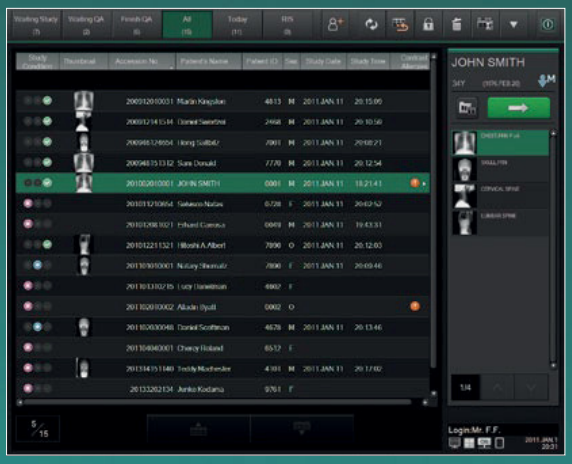

Fukcje wyświetlania kolorowych przycisków informacji o statusie oraz miniatur zostały zintegrowane, co zapewnia natychmiastowe sprawdzenie i potwierdzenie informacji uzyskanych w czasie badania. Wybór typu badania jest bardzo łatwy.

Ekran kontroli jakości



Przyporządkowane do typu pracy przyciski operacyjne dostosowują się do przepływu pracy i pozwalają na efektywne zarządzanie funkcjami kontroli jakości. Każda funkcja jest objaśniona w tekście pomocy, co znacznie ułatwia zrozumienie funkcjonowania urządzenia.

ZAAWANSOWANE


FUNKCJE



Funkcja precyzyjnego powiększenia (Opcjonalna)

Podłączenie konsoli do dodatkowego monitora umożliwia precyzyjną analizę obrazu na monitorze o wysokiej rozdzielczości. Na drugim monitorze wyświetlane są również dane tekstowe, aby umożliwić potwierdzanie informacji o pacjencie oraz parametry ekspozycji*. Zróżnicowane opcje powiększania obrazu umożliwiają znacznie dokładniejszą diagnozę.

* Jeśli opcja X-con jest zainstalowana.

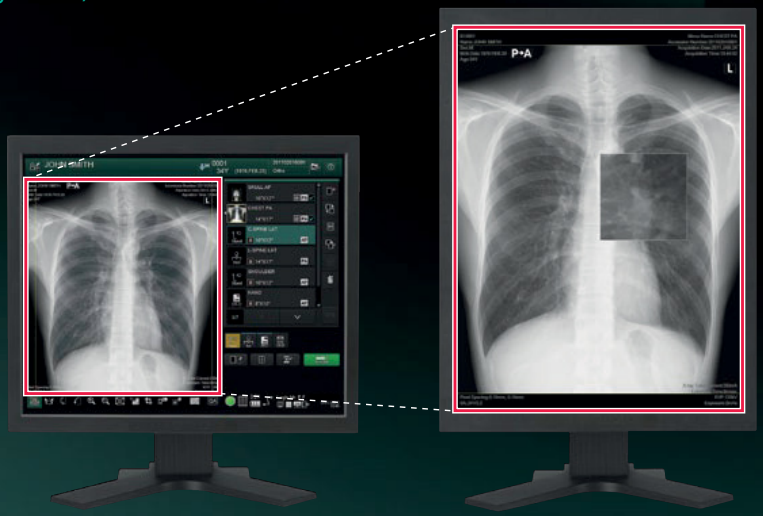

Funkcja korekty obrazu ROI

Dzięki unikalnej technologii korekty obrazu FUJIFILM możliwa jest optymalizacja wyświetlanego obrazu i jego reprocesowanie co umożliwia często w pełni automatyczne dopasowanie idealnego obrazu bez manualnej pracy technika.



Funkcja scalania obrazów (Opcjonalna)


Funkcja automatycznego scalania obrazów łączy wiele różnych obrazów w jeden, co umożliwia przeanalizowanie większego obszaru. Możliwe jest scalenie maksymalnie pięciu obrazów*.

* Wyłącznie do badań z użyciem FDR AcSelerate



Funkcja automatycznego trymowania

Konsola wykrywa automatycznie obszar poddany naświetlaniu i dostraja obraz do odpowiedniego rozmiaru lub do wielkości odpowiadającej badanemu obszarowi. Ta funkcja umożliwia technikowi ekspozycję w dowolnym miejscu i na dowolnej wielkości płycie lub panelu

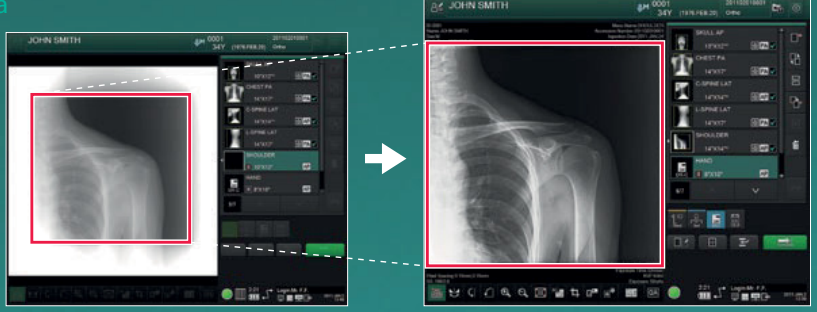

Dane techniczne KONSOLI ADVANCE

Podzespoły standardowe

1. Jednostka sterująca
2. Ekran
3. Oprogramowanie użytkowe
4. Zestaw akcesoriów
5. Kabel zasilający

Wymiary zewnętrzne i ciężar

	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Ciężar
Jednostka główna	ok. 114 mm	ok. 353 mm	ok. 399 mm	ok. 8.3 kg
Klawiatura	ok. 460 mm	ok. 170 mm	ok. 30 mm	ok. 1 kg
Monitor kolorowy 17″	ok. 380 mm	ok. 208.5 mm	ok. ~450 mm	ok. 8.2 kg
Monitor kolorowy 21,3″	ok. 376 mm	ok. 208.5 mm	ok. ~550 mm	ok. 9.4 kg
Monitor monochromatyczny 21,3″	ok. 376 mm	ok. 208.5 mm	ok. 604.5 mm	ok. 9.9 kg
Monitor kolorowy 21,2″	ok. 376 mm	ok. 208.5 mm	ok. 604.5 mm	ok. 10.4 kg
Monitor monochromatyczny 20,8″	ok. 368 mm	ok. 208.5 mm	ok. 597.5 mm	ok. 9.2 kg

Zasilanie

	Napięcie sieci	Prąd znamionowy
Jednostka główna	AC90~265V	3.6A/1.8A
Monitor kolorowy 17″	AC100~120V/AC220~240V	0.6A/0.3A
Monitor kolorowy 21,3″	AC100~120V/AC220~240V	1.2A/0.6A
Monitor monochromatyczny 21,3″	AC100~120V/AC220~240V	1.1A/0.5A
Monitor kolorowy 21,2″	AC100~120V/AC220~240V	1.2A/0.6A
Monitor monochromatyczny 20,8″	AC100~120V/AC220~240V	1.0A/0.5A

KONSOLA ADVANCE DR-ID 300CL

CE 0123

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie nazwy firmowe lub znaki handlowe stanowią wyłączną własność odnośnych podmiotów. Do importowania urządzeń medycznych do niektórych krajów może być wymagana aprobata organu nadzorującego. Prosimy o kontakt z przedstawicielem lokalnym, aby uzyskać informacje o dostępności przedstawionych produktów.

FUJIFILM

Producer : **FUJIFILM Corporation**

26-30, NISHIAZABU 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 106-8620, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/medical/

Ref. No. XB-983E

Przedstawicielstwo FUJIFILM w Polsce:

FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa
Tel: (22) 517-66-00, Fax: (22) 517-66-04
Email: medycyna@fujifilm.pl

Wydrukowano w Polsce © FUJIFILM Europe GmbH